

Laboratory Name: رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد



Save

RBio9 - Biochemistry-General - APP - U/L


صفحه گذاری.روش

صفحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

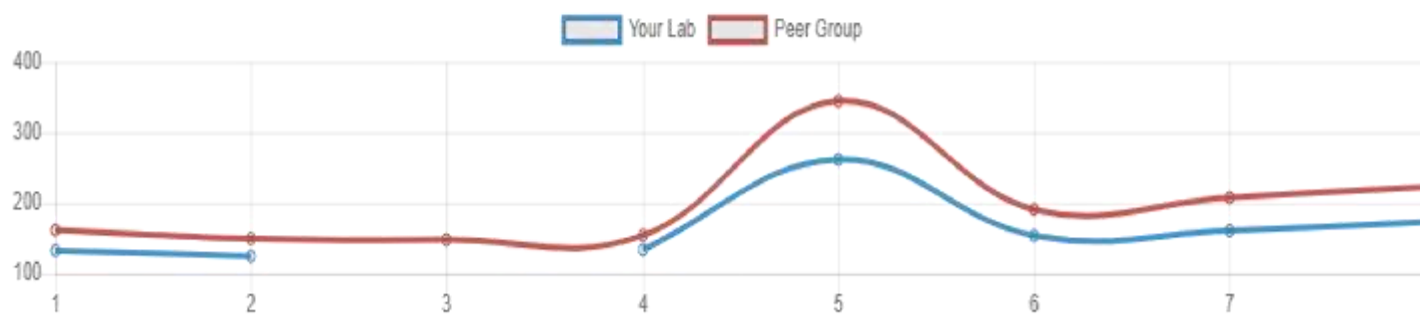

- Included Runs: 6
- Total Bias% : -10.42

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	133.00	161.97	12	13.03	1.37	17.88-
2	1400/11/13	125.00	149.78	22	14.78	1.12	16.54-
3	1400/11/20		148.22	18			
4	1400/11/27	134.00	154.44	20	8.87	1.49	13.23-
5	1400/12/4	262.00	344.75	21	11.71	2.05	24.00-
6	1400/12/11	154.00	191.16	21	13.18	1.47	19.44-
7	1400/12/18	161.00	207.79	16	Out of Range		
8	1400/12/25	173.00	223.13	16	10.52	2.14	22.47-

عدم شرکت در دوره

اقدام اصلاحی: کالیبراسیون دستگاه