

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - AST - U/L


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

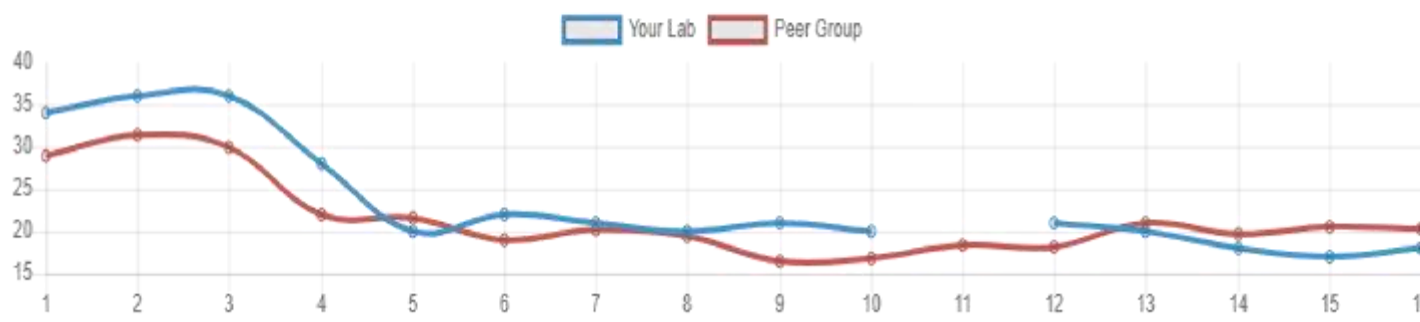

- Included Runs: 14
- Total Bias% : 4.28

محاسبه تورش

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	34.00	28.91	21	16.92	1.04	17.60
2	1401/2/28	36.00	31.39	26	9.48	1.55	14.70
3	1401/3/4	36.00	29.93	17	12.30	1.65	20.28
4	1401/3/11	28.00	21.97	22	Out of Range		
5	1401/3/18	20.00	21.57	20	8.41	0.87	7.28-
6	1401/3/25	22.00	18.97	20	10.99	1.45	15.99
7	1401/4/1		20.19	25			
8	1401/4/8	21.00	19.42	24	8.05	1.01	8.13
9	1401/4/15	20.00	16.47	25	10.50	2.04	21.45
10	1401/4/22	18.00	16.81	21	11.46	0.62	7.05
11	1401/4/29	17.00	18.37	23	7.69	0.97	7.47-
12	1401/5/5	18.00	18.15	24	8.85	0.09	0.84-
13	1401/5/12	21.00	21.00	21	7.64	0.00	0.02-
14	1401/5/19	20.00	19.69	13	9.41	0.17	1.56
15	1401/5/26	21.00	20.55	22	8.11	0.27	2.20
16	1401/6/2	20.00	20.30	22	6.92	0.22	1.50-

اقدام اصلاحی: بررسی اتونالیزور

عدم شرکت در دوره