

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save


RBio9 - Biochemistry-General - Ca - mg/dL

صحة گذاری.روش

صحة گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

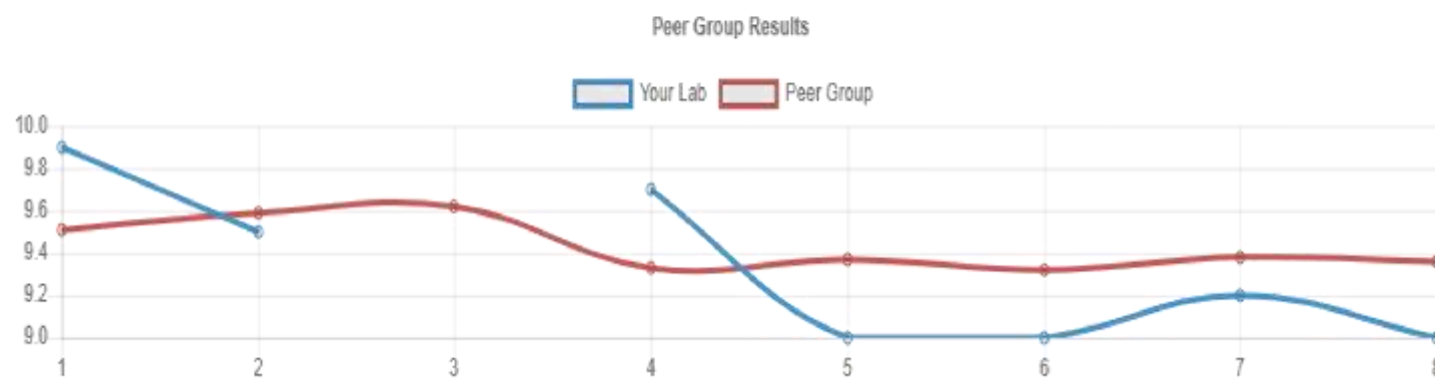

- Included Runs: 7
- Total Bias% : -0.49

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	9.90	9.51	15	4.17	0.98	4.10
2	1400/11/13	9.50	9.59	21	4.57	0.20	0.90-
3	1400/11/20		9.62	19			
4	1400/11/27	9.70	9.33	23	3.38	1.17	3.97
5	1400/12/4	9.00	9.37	19	2.63	1.51	3.99-
6	1400/12/11	9.00	9.32	21	3.84	0.90	3.45-
7	1400/12/18	9.20	9.38	20	3.27	0.60	1.96-
8	1400/12/25	9.00	9.36	15	2.56	1.50	3.83-

عدم شرکت در دوره