

Laboratory Name: رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - Glucose - mg/dL


صحة گذاری روش

صحة گذاری روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

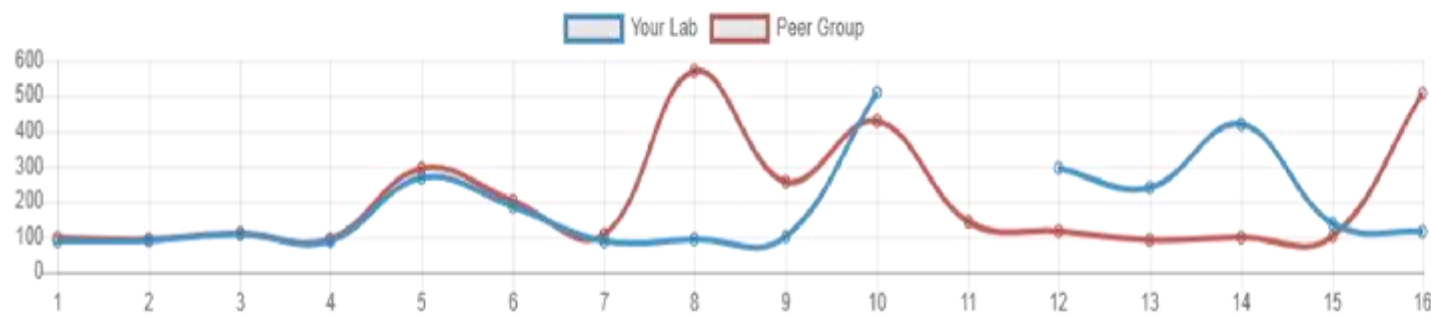

- Included Runs: 14
- Total Bias% : -2.97

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	88.00	98.02	20	4.87	2.10	10.22-
2	1401/2/28	90.00	93.47	25	5.72	0.65	3.71-
3	1401/3/4	108.00	110.77	18	5.40	0.46	2.50-
4	1401/3/11	88.00	93.73	27	4.82	1.27	6.11-
5	1401/3/18	268.00	294.46	23	4.95	1.82	8.98-
6	1401/3/25	186.00	202.53	22	4.64	1.76	8.16-
7	1401/4/1		107.29	26			
8	1401/4/8	296.00	570.95	19	Out of Range		
9	1401/4/15	240.00	256.82	25	5.28	1.24	6.55-
10	1401/4/22	420.00	429.22	27	5.45	0.39	2.15-
11	1401/4/29	138.00	143.47	23	3.54	1.08	3.82-
12	1401/5/5	115.00	116.78	26	2.94	0.52	1.53-
13	1401/5/12	88.00	91.61	24	4.02	0.98	3.94-
14	1401/5/19	94.00	98.91	14	3.32	1.49	4.96-
15	1401/5/26	101.00	102.60	21	2.95	0.53	1.55-
16	1401/6/2	510.00	507.57	22	4.84	0.10	0.48

عدم شرکت در دوره

اقدام اصلاحی: بررسی خطی بودن کیت گلوکز