

رصد : Laboratory Name

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - Hb1-C - mg/dL


صحه گذاری روش

صحه گذاری روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

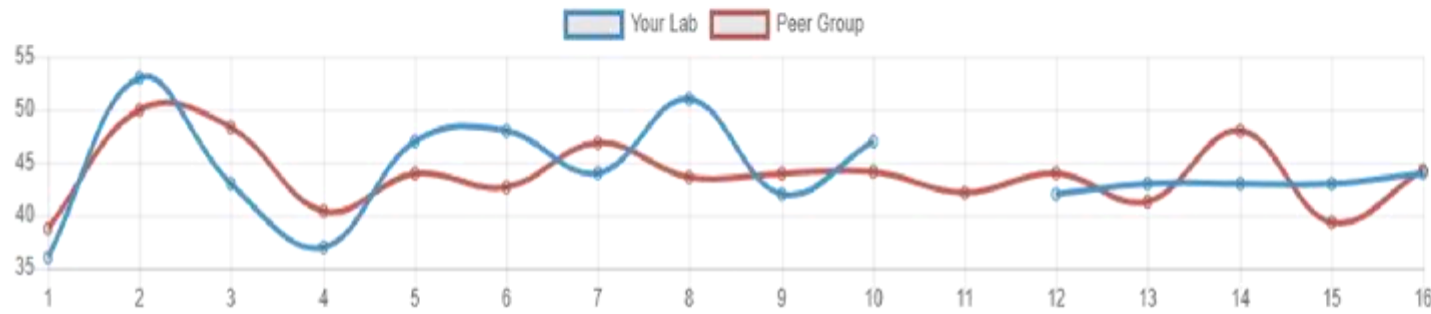

- Included Runs: 15
- Total Bias% : 0.81

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	36.00	38.73	21	11.83	0.60	7.06-
2	1401/2/28	53.00	49.96	22	11.70	0.52	6.09
3	1401/3/4	43.00	48.33	19	11.13	0.99	11.02-
4	1401/3/11	37.00	40.40	24	12.37	0.68	8.43-
5	1401/3/18	47.00	43.97	22	12.07	0.57	6.90
6	1401/3/25	48.00	42.67	22	10.88	1.15	12.50
7	1401/4/1		46.86	25			
8	1401/4/8	42.00	43.62	23	8.40	0.44	3.71-
9	1401/4/15	43.00	43.96	24	6.72	0.32	2.18-
10	1401/4/22	43.00	44.13	25	6.66	0.38	2.55-
11	1401/4/29	43.00	42.14	23	8.54	0.24	2.04
12	1401/5/5	44.00	44.01	25	9.54	0.00	0.02-
13	1401/5/12	44.00	41.30	23	9.67	0.68	6.55
14	1401/5/19	51.00	48.00	14	13.50	0.46	6.26
15	1401/5/26	42.00	39.34	23	8.62	0.78	6.75
16	1401/6/2	47.00	44.25	22	10.68	0.58	6.21

عدم شرکت در دوره