

Laboratory Name: رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - Hb A1C - %


صحة گذاری روش

صحة گذاری روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

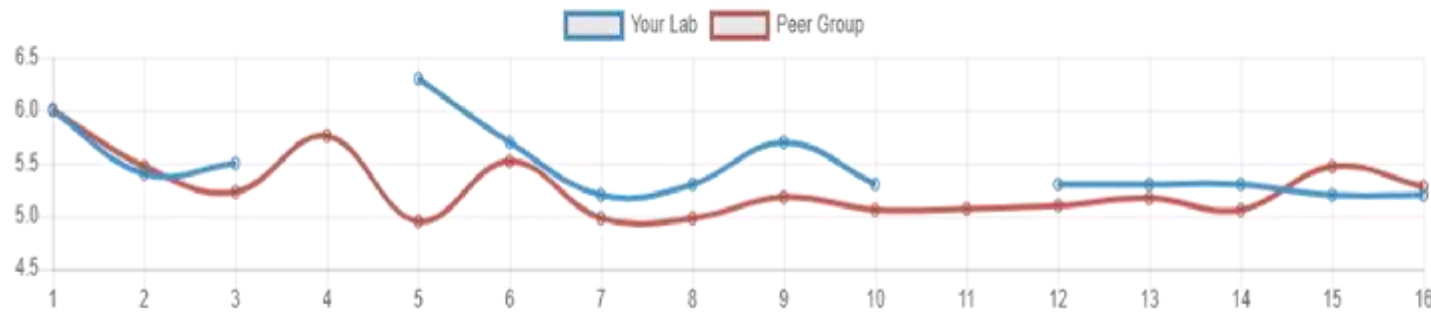

- Included Runs: 13
- Total Bias% : 1.73

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	6.00	6.01	12	10.87	0.01	0.14-
2	1401/2/28	5.40	5.47	21	6.98	0.18	1.25-
3	1401/3/4	5.50	5.23	18	6.76	0.76	5.11
4	1401/3/11		5.76	17			
5	1401/3/18	6.30	4.95	15	Out of Range		
6	1401/3/25	5.70	5.52	17	8.09	0.40	3.20
7	1401/4/1		4.98	19			
8	1401/4/8	5.30	4.98	20	7.72	0.83	6.43
9	1401/4/15	5.30	5.18	17	5.53	0.43	2.39
10	1401/4/22	5.30	5.06	22	9.58	0.50	4.81
11	1401/4/29	5.20	5.07	17	6.75	0.38	2.55
12	1401/5/5	5.20	5.10	22	8.10	0.24	1.95
13	1401/5/12	5.20	5.17	19	8.18	0.06	0.52
14	1401/5/19	5.30	5.06	12	11.07	0.43	4.78
15	1401/5/26	5.70	5.47	18	8.06	0.52	4.23
16	1401/6/2	5.30	5.28	19	6.83	0.06	0.44

عدم شرکت در دوره

ثبت اشتباه جواب - عدد صحیح 5.30

عدم شرکت در دوره