

Laboratory Name: رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio9 - Biochemistry-General - LDL-C - mg/dL


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

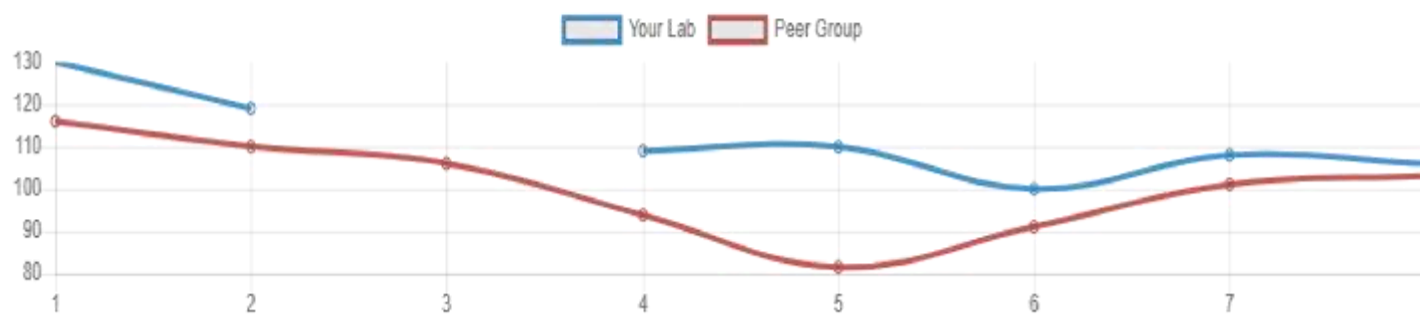

- Included Runs: 5
- Total Bias% : 4.18

محاسبه تورش

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	130.00	115.98	12	9.74	1.24	12.09
2	1400/11/13	119.00	110.07	16	8.07	1.01	8.11
3	1400/11/20		106.06	16			
4	1400/11/27	109.00	93.87	11			
5	1400/12/4	110.00	81.54	14			
6	1400/12/11	100.00	91.09	15	5.31	1.84	9.79
7	1400/12/18	108.00	101.12	13	6.88	0.99	6.81
8	1400/12/25	106.00	103.13	12	7.20	0.39	2.79

عدم شرکت در دوره

غیرقابل ارزیابی توسط برنامه

غیرقابل ارزیابی توسط برنامه