

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - Na - mmol/L


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

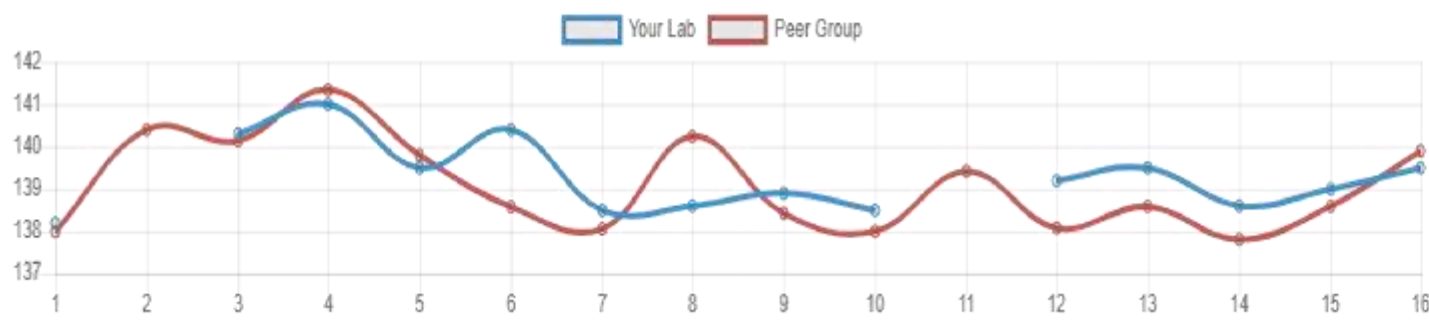

- Included Runs: 14
- Total Bias% : 0.10

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%	وضعیت
1	1401/2/21	138.20	137.99	18	1.86	0.08	0.15	✓
2	1401/2/28		140.40	17				✗
3	1401/3/4	140.30	140.14	19	2.07	0.05	0.11	✓
4	1401/3/11	141.00	141.34	21	1.67	0.14	0.24-	✓
5	1401/3/18	139.50	139.80	17	1.67	0.13	0.21-	✓
6	1401/3/25	140.40	138.58	16	1.59	0.83	1.32	✓
7	1401/4/1		138.06	21				✗
8	1401/4/8	139.20	140.24	20	1.15	0.64	0.74-	✓
9	1401/4/15	139.50	138.43	21	1.56	0.49	0.77	✓
10	1401/4/22	138.60	138.00	20	1.46	0.30	0.44	✓
11	1401/4/29	139.00	139.42	17	1.61	0.19	0.30-	✓
12	1401/5/5	139.50	138.08	25	1.62	0.64	1.03	✓
13	1401/5/12	138.50	138.59	19	1.30	0.05	0.07-	✓
14	1401/5/19	138.60	137.81	14	1.25	0.46	0.57	✓
15	1401/5/26	138.90	138.59	17	1.64	0.14	0.22	✓
16	1401/6/2	138.50	139.90	22	1.48	0.68	1.00-	✓

عدم شرکت در دوره

عدم شرکت در دوره