

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

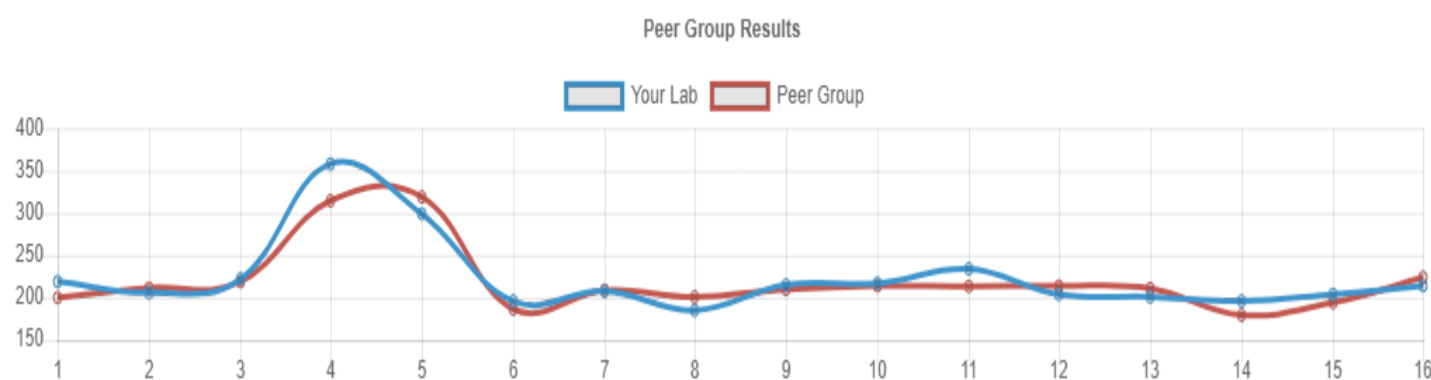
صحیح گذاری. روش

صحیح گذاری. روش

پانل آزمایشگاه

خروج

RHem10 - Hematology - PLT

PLT - $\mu\text{l}/10^3$ 

- Included Runs:
16
- Total Bias% :
1.12

محاسبه تورش

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	219.00	200.17	23	8.33	1.13	9.40
2	1401/2/28	206.00	211.36	22	5.64	0.45	2.54-
3	1401/3/4	222.00	218.80	25	6.55	0.22	1.46
4	1401/3/11	358.00	314.46	26	5.90	2.35	13.85
5	1401/3/18	299.00	318.95	21	4.55	1.38	6.26-
6	1401/3/25	196.00	186.65	20	6.29	0.80	5.01
7	1401/4/1	234.00	208.79	28	8.70	1.39	12.08
8	1401/4/8	204.00	200.87	23	6.08	0.26	1.56
9	1401/4/15	201.00	209.89	27	7.11	0.60	4.24-
10	1401/4/22	196.00	214.00	28	8.82	0.95	8.41-
11	1401/4/29	204.00	213.43	28	7.09	0.62	4.42-
12	1401/5/5	214.00	213.71	24	6.77	0.02	0.14
13	1401/5/12	208.00	210.89	27	6.82	0.20	1.37-
14	1401/5/19	185.00	179.41	17	8.38	0.37	3.11
15	1401/5/26	215.00	194.29	24	8.11	1.31	10.66
16	1401/6/2	217.00	223.96	26	6.90	0.45	3.11-