

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RHem10 - Hematology - RBC RBC - 6*10/uI


صحیح گذاری. روش

صحیح گذاری. روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

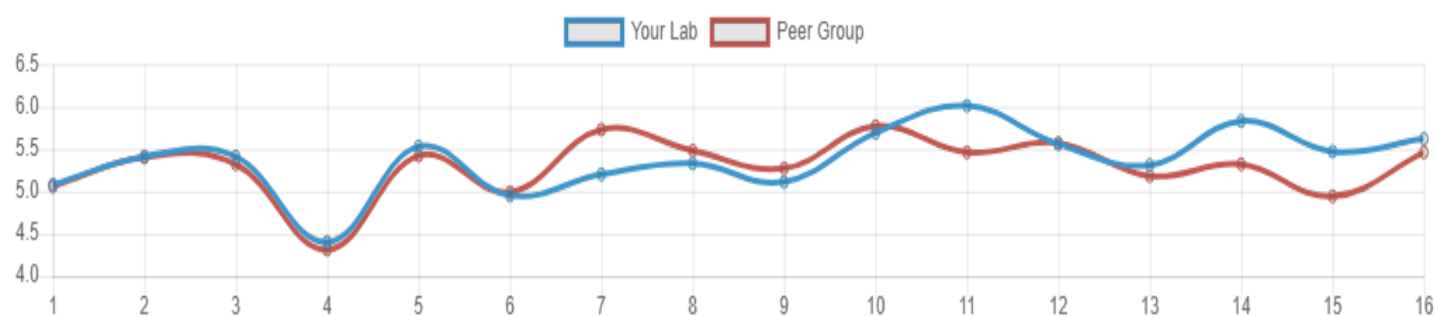

- Included Runs:
16
- Total Bias% :
0.95

محاسبه تورش

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	5.08	5.06	22	1.53	0.25	0.38
2	1401/2/28	5.41	5.40	23	1.79	0.09	0.16
3	1401/3/4	5.41	5.32	25	2.79	0.57	1.60
4	1401/3/11	4.40	4.31	27	2.24	0.94	2.10
5	1401/3/18	5.53	5.42	22	1.94	1.00	1.94
6	1401/3/25	4.95	4.99	22	2.74	0.28	0.77-
7	1401/4/1	6.01	5.73	28	3.28	1.49	4.89
8	1401/4/8	5.56	5.48	27	2.58	0.55	1.42
9	1401/4/15	5.31	5.27	28	2.32	0.36	0.83
10	1401/4/22	5.83	5.77	28	2.08	0.50	1.03
11	1401/4/29	5.47	5.46	27	2.21	0.10	0.22
12	1401/5/5	5.62	5.57	23	1.62	0.57	0.92
13	1401/5/12	5.20	5.18	27	2.09	0.20	0.42
14	1401/5/19	5.33	5.32	17	2.03	0.10	0.21
15	1401/5/26	5.11	4.94	24	2.85	1.19	3.38
16	1401/6/2	5.69	5.46	25	2.53	1.65	4.17