

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio9 - Biochemistry-General - Urea - mg/dL


صحه گذاری.روش

صحه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

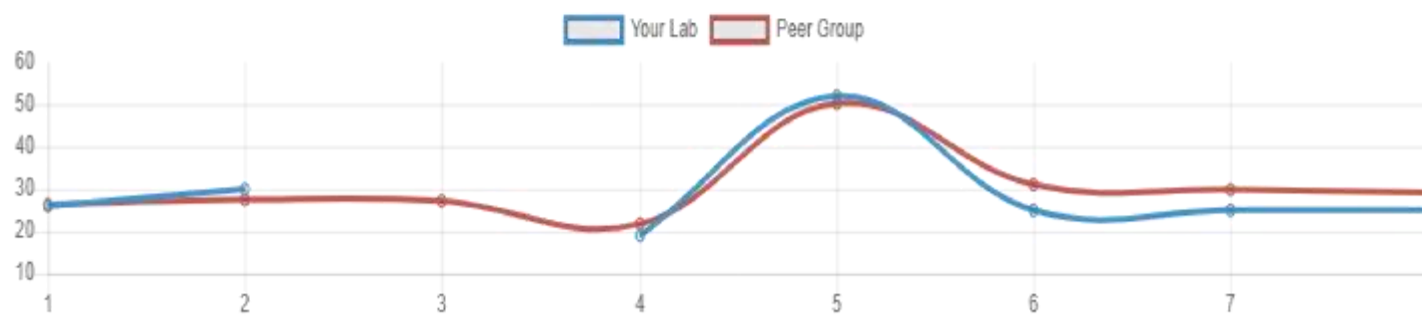

- Included Runs: 6
- Total Bias% : -2.96

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	26.00	26.35	13	7.89	0.17	1.34-
2	1400/11/13	30.00	27.50	22	8.83	1.03	9.08
3	1400/11/20		27.18	19			
4	1400/11/27	19.00	21.78	21	12.96	0.98	12.74-
5	1400/12/4	52.00	50.25	19	3.93	0.89	3.48
6	1400/12/11	25.00	31.04	16	Out of Range		
7	1400/12/18	25.00	29.85	18	7.81	2.08	16.25-
8	1400/12/25	25.00	29.23	16	6.55	2.21	14.48-

عدم شرکت در دوره

غیرقابل ارزیابی توسط برنامه