

Laboratory Name : رصد

حكيمه بابايي

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - Urea - mg/dL


صحة گذارى.روش

صحة گذارى.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

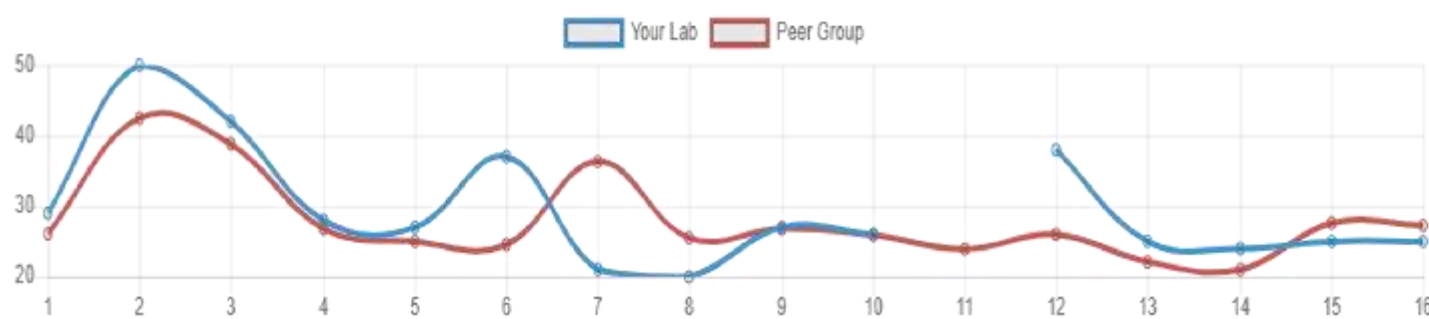

- Included Runs: 12
- Total Bias% : 0.10

محاسبه تورش

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	29.00	26.07	18	9.08	1.24	11.24
2	1401/2/28	50.00	42.46	23	Out of Range		
3	1401/3/4	42.00	38.80	20	4.87	1.70	8.25
4	1401/3/11	28.00	26.80	21	7.28	0.61	4.46
5	1401/3/18	27.00	25.00	19	5.52	1.45	7.98
6	1401/3/25	37.00	24.56	19	Out of Range		
7	1401/4/1		36.31	26			
8	1401/4/8	38.00	25.50	22	Out of Range		
9	1401/4/15	25.00	26.81	22	4.56	1.48	6.74
10	1401/4/22	24.00	25.90	26	6.88	1.07	7.34
11	1401/4/29	25.00	23.92	22	6.27	0.72	4.53
12	1401/5/5	25.00	26.00	26	9.49	0.40	3.83
13	1401/5/12	21.00	22.10	24	7.66	0.65	4.98
14	1401/5/19	20.00	21.00	13	8.06	0.59	4.74
15	1401/5/26	27.00	27.62	24	7.45	0.30	2.26
16	1401/6/2	26.00	27.26	22	8.15	0.57	4.61

اقدام اصلاحی: بررسی کالیبراسیون کیت

اقدام اصلاحی: بررسی کیفیت کیت

عدم شرکت در دوره

اقدام اصلاحی: تغییر شرکت سازنده کیت