

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

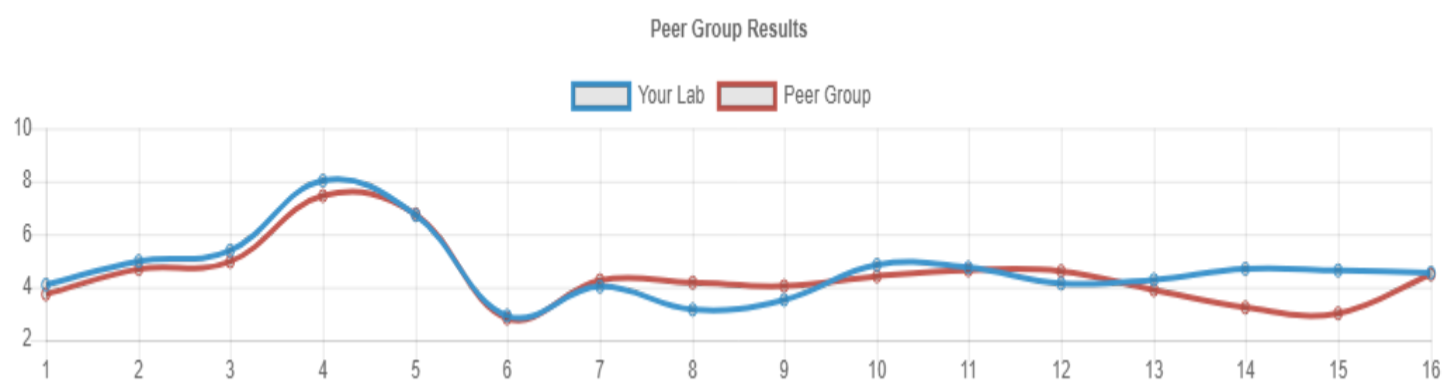
آزمایشگاه رصد

صححه گذاری.روش

صححه گذاری.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

RHem10 - Hematology - WBC WBC - $\mu\text{l}/10^3$ 

- Included Runs:
16
- Total Bias% :
3.44

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	4.09	3.73	23	7.76	1.25	9.69
2	1401/2/28	4.98	4.68	24	5.62	1.14	6.42
3	1401/3/4	5.38	4.96	24	6.16	1.39	8.55
4	1401/3/11	8.02	7.45	26	5.62	1.37	7.69
5	1401/3/18	6.72	6.75	21	7.17	0.06	0.45-
6	1401/3/25	2.92	2.82	22	7.89	0.43	3.40
7	1401/4/1	4.74	4.26	29	7.06	1.60	11.30
8	1401/4/8	4.14	4.17	26	5.83	0.12	0.72-
9	1401/4/15	4.28	4.04	26	6.91	0.85	5.87
10	1401/4/22	4.69	4.41	29	6.75	0.93	6.31
11	1401/4/29	4.63	4.64	26	6.35	0.02	0.13-
12	1401/5/5	4.54	4.60	25	5.77	0.23	1.31-
13	1401/5/12	4.02	3.89	27	8.01	0.42	3.34
14	1401/5/19	3.15	3.23	16	10.44	0.23	2.40-
15	1401/5/26	3.52	3.01	21	4.22	4.06	17.13
16	1401/6/2	4.84	4.48	26	5.51	1.45	7.97