

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save


RBio9 - Biochemistry-General - Zn - µg/dL

صحة گذارى.روش

صحة گذارى.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

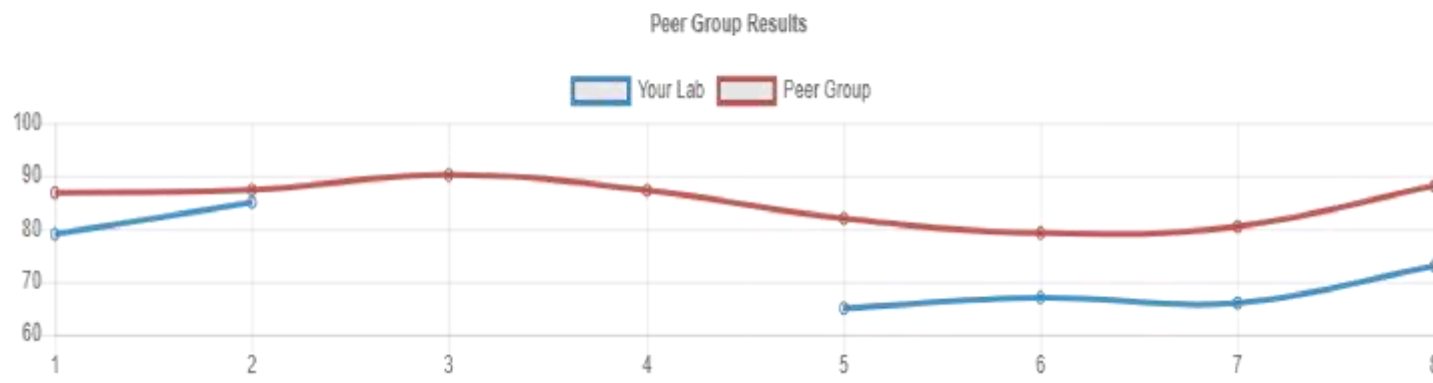

- Included Runs: 6
- Total Bias% : -7.61

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1400/11/6	79.00	86.83	12	8.99	1.00	9.02-
2	1400/11/13	85.00	87.35	17	11.74	0.23	2.69-
3	1400/11/20		90.19	15			
4	1400/11/27		87.27	15			
5	1400/12/4	65.00	81.95	17	14.64	1.41	20.69-
6	1400/12/11	67.00	79.21	15	12.51	1.23	15.41-
7	1400/12/18	66.00	80.45	17	11.87	1.51	17.96-
8	1400/12/25	73.00	88.10	13	10.76	1.59	17.14-

عدم شرکت در دوره

عدم شرکت در دوره