

Laboratory Name : رصد

حکیمه بابایی

آزمایشگاه رصد

Save

RBio10 - Biochemistry-General - Zfl - µg/dL


صحه گذارى.روش

صحه گذارى.روش

پانل آزمایشگاه

خروج

Peer Group Results

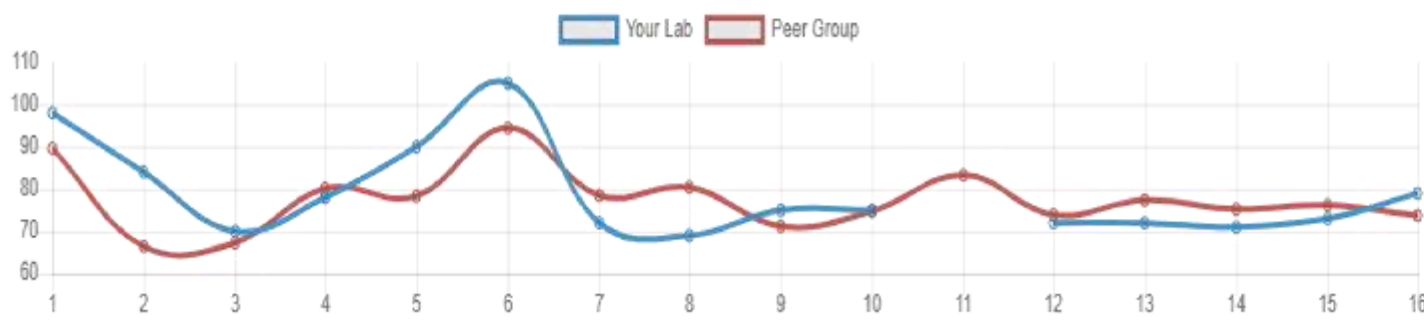

- Included Runs: 14
- Total Bias% : 0.08

حداقل میزان CV

حداقل تعداد همگروه

محاسبه تورش

ردیف	تاریخ	نتیجه آزمایشگاه	نتیجه همگروه	تعداد همگروه	CV%	DI	TAE%
1	1401/2/21	98.00	89.62	17	12.84	0.73	9.35
2	1401/2/28	84.00	66.44	16	Out of Range		
3	1401/3/4	70.00	67.34	15	7.44	0.53	3.95
4	1401/3/11	78.00	80.16	18	11.29	0.24	2.70-
5	1401/3/18	90.00	78.35	19	11.55	1.29	14.87
6	1401/3/25	105.00	94.41	21	11.79	0.95	11.22
7	1401/4/1		78.48	23			
8	1401/4/8	72.00	80.43	21	10.27	1.02	10.48-
9	1401/4/15	72.00	71.20	19	8.15	0.14	1.12
10	1401/4/22	71.00	74.75	21	10.24	0.49	5.02-
11	1401/4/29	73.00	83.28	21	10.47	1.18	12.34-
12	1401/5/5	79.00	73.91	20	8.65	0.80	6.89
13	1401/5/12	72.00	77.36	21	11.29	0.61	6.93-
14	1401/5/19	69.00	75.26	12	16.06	0.52	8.32-
15	1401/5/26	75.00	76.23	18	10.34	0.16	1.61-
16	1401/6/2	75.00	73.74	19	8.85	0.19	1.71

اقدام اصلاحی: بررسی کیفیت آب مقطر

عدم شرکت در دوره